


Seradigm 生産工程

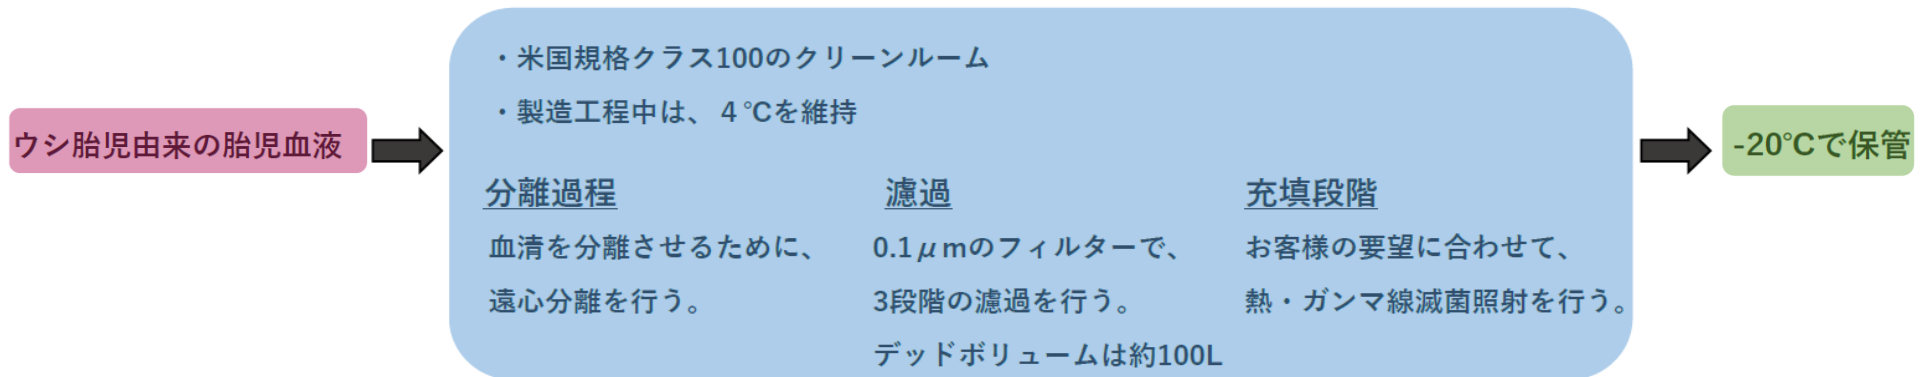

*Seradigmが高品質の血清を製造する工程

- ・他社においては、生産工程中の温度を16℃で維持している。
- ・4℃の生産温度はより多くの増殖因子を維持することが可能。
- ・最大ロット：2000L

avantor 